



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET  
HASTANESİ  
08/06/2021 11:49 - E-52446582 - 949 - 407



Sayı : 35277066-949

Konu : LAZER FİBERİ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (11.06./2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 17.06(Yüzübirinci). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HOLMIUM / HO YAG LAZER TAŞ KIRMA PROBÜ FİBERİ 550 MİKRON	3	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Emin TILYAKI İletişim:

0530 079 2416

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 65a95b2e-6561-492f-b8cf-50deb05974b4



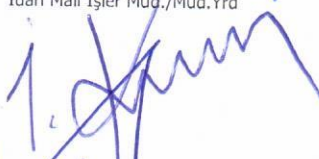
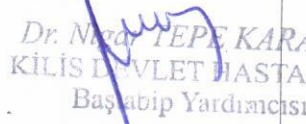
Belge Doğrulama Adresi: <http://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



3

 Sağlık Bakanlığı	<b>T.C. KİLİS VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kilis Devlet Hastanesi</b>	 KİLİS DEVLET HASTANESİ
<b>MALZEME/BAKIM/CİHAZ İSTEK FORMU</b>		

Doküman Kodu :KY.FR.41	Yayın Tarihi:Aralık 2015	Revizyon Tarihi:Aralık 2017	Revizyon No:2
<b>İSTEK YAPAN BİRİM/SERVİS</b>		<b>İDARİ ONAYLAYAN</b>	<b>TARİH VE SAYI</b>
TALEP EDEN BÖLÜM : BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO BÖLÜM SORUMLUSU : SÜLEYMAN FERMANCI			28.05.2021
İmza :			46.154
		<b>TALEP EDEN BİRİMİN GEREKÇESİ</b>	
ÜRETER VE BÖBREK AMELİYATINDA KULLANILMAK ÜZERE LAZER FİBERLERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.			
<b>Sıra No</b>	<b>Stok/Taşınır</b>	<b>Malzeme/Hizmet Adı</b>	<b>Farmasötik Form</b>
<b>Birim</b>	<b>Talep Miktar</b>	<b>STOK KONTROLÜ</b>	
		Hastane Stokunda	Birliğe Bağlı Hastaneler
		Türkiye Genel Sorgulama	<b>FİYAT KONTROLÜ</b>
		Ort.Mkys Fiyatı	EnSonAlım Fiyatı
		Sut Kodu	Sut Fiyatı
		Var Yok	Var Yok
1	DG - 10000.00352 150-03-03-240052532	HOLMIUM / HO YAG LAZER TAŞ KIRMA PROBU	ADET
			3
<b>Genel Bütçe</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Döner Sermaye</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Doğrudan Temin</b>	<input type="checkbox"/>	<b>İhale</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bütçe Kalemi Kodu(Analitik Kodlar)</b>	03.02.06.02	Bütçe Kontrolü Yapılmıştır.	Bütçe Kontrolü Yapan
<b>%10 Kullanılabilir Ödenek Tutarı</b>	699.504,71	03/06/2021	
			Stok Kontrol Sorumlusu(TKY)
			SÜLEYMAN FERMANCI

<b>İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU</b>			
Tıbbi Mal/Dayanıklı Tüketim/Biyomedikal Hizmetleri	Sağlık Bakım Hizmetleri	İdari Mali İşler Müd./Müd.Yrd	Komisyon Başkanı
 Süleyman FERMANCI Kilis Devlet Hastanesi Biyomedikal Depo Birimi Tıbbi Sekreter	 Hatice AKKAPTAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü		 Dr. Nergis TEPE KARAKIŞ KİLİS DEVLET HASTANESİ Başabip Yardımcısı
ONAY ..... / .. / .. ERKAN KURTARAN Başhekim			

**EK:Teknik Şartname .**

- 1-Talebi yapan bölüm/depo istemiş olduğu mal-malzemeler için gerekli kodları ve malzeme tanımını(Malzeme Kodu/DMO Kodu/Taşınır Kodu)eksiksiz olarak dolduracaktır.
- 2-Talep eden birim sorumlusu Satın alma ile iletişimi sağlamak için telefon numarası yazılmalıdır.
- 3-Talep edilen mal-malzemeler için ilgili Depodan Teknik birimden görüş alınarak,taşınır kayıt kontrol yetkilisine imzalatılmalıdır.Hizmet ve yapım
- 4-Talebi yapılan mal-malzemelerin özelliklerini açıklayan teknik şartnameler açık,anlaşılır ve rekabeti engelleyen ifadelere yer verilmeksizin (marka
- 5-Bütçe kayıt işlemleri satınalma birimi tarafından yapılacaktır.

Quanta System Litho Reusable Holmium Lazer Fiberi Şartnamesi (3 (üç) ADET)

- 1.) Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
- 2.) Fiberler 2100 nm holmium lazer enerjisini taşımalı ve 532 nm ile 2250 nm aralığında dalga boylarıyla çalışabilmeli.
- 3.) Fiber çapı öz çapı 550 mikron, kaplamayla çapı 600 mikron, blue bufferla çapı 630 mikron olmalıdır.
- 4.) Fiber konnektörü Yüksek Enerji SMA905 ve Freestanding konnektör olmalıdır.
- 5.) Fiber temaslı, yarı temaslı ve temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6.) Fiber Low OH Silica-Silica N.A. 0.22 yapıda malzemedan imal edilmiş, dış yüzeyi blue buffer ve ETFE kaplı olmalıdır.
- 7.) Fiberler reusable özellikte olmalı, uç kısmından kesilerek tamir edilebilmelidir.
- 8.) Fiberler etilen oksit sterilizasyonuna ve 134°C otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- 9.) Fiber boyu en az 3 metre  $\pm 0,2m$ . uzunlukta olmalıdır.
- 10.) Fiber distal ucu bare tip, 5mm  $\pm 1mm$ . Soyulmuş olmalıdır.
- 11.) Teklif edilen fiberler etilen oksit steril paketlenmiş olmalıdır. Steril paketler iç içe 2 paket halinde olmalıdır.
- 12.) Fiberlerin raf ömrü paketlenme tarihinden itibaren en az 5 yıl olmalıdır.
- 13.) Fiberler etilen oksit ve otoklav sterilizasyonuna uygun olmalı 134° de 5dk. Ve 2 bar basınçta otoklavda steril edilebilmelidir.
- 14.) Teklif edilen fiberler hastanemiz bünyesinde bulunan QuantaSystem marka Litho model holmium lazer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. İdare cihazda fibere bağlı arıza çıkması halinde bu madde gereği inceleme başlatma hakkına sahiptir. Bu durumun kabul edildiğine dair taahhütname ihale dosyasında istekliler tarafından sunulacaktır.

Op. Dr. Erdi KOLUŞ  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 156341/23359

Op. Dr. Hasan ASLAN  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 128629

Op. Dr. Erbay TÜMER  
Kilis Devlet Hastanesi  
Üroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 162755