

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS SATIN ALMA
BİRLİĞİ

15.02.2018 14:38 - 35277066 - 949 - E.23



00062733151

Sayı : 52446582/949

Konu : 6 Kalem Tüketim Malzemesi Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **16 / 02 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PC Monitör Duvar Askı Aparatı (Hareketli)	15	ADET		
2	15 Metre VGA Kablo(15-pin Male to Male)	15	ADET		
3	10 Metre VGA Kablo(15-pin Male to Male)	10	ADET		
4	20 Metre VGA Kablo(15-pin Male to Male)	5	ADET		
5	5 Metre VGA Kablo(15-pin Male to Male)	5	ADET		
6	Cat6 Konnektör Ucu	200	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

Kilis Devlet Hastanesi – Doğrudan Temin Birimi
Tel: 0348 822 11 11 Dahili: 1872 Faks:
İrt: Tefik ALKAN

Abdullah GÜL Bulv.Çevre Yolu Üzeri, Merkez/Kilis
e-posta : kilisdeviethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 33fd170e-8426-4208-bafb-6884fa5d5566 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

TEKNİK ŞARTNAME

PC Monitör Duvar Askı Aparatında İstenilen Özellikler

LCD ve LED bilgisayar monitörlerine uygun olup, dış malzemesi gerçek döküm çelikten olmalı


Monitör montajı: 15" ile 24"(widescreen) ve 17" ile 19"(kare) ekranlara tam uyumlu olmalı

Montaj sonunda aparat hareketleri; Yukarı, aşağı, sol ve sağ yönlere 90° dönebilmeli

Dış malzemesi gerçek döküm çelikten olup, taşıyabileceği ağırlık 15Kg(max) olmalı

Vesa standartlarına: 100x100, 75x75, 50x50 ölçülerine tam uymalı

Montaj için tüm aparatlar ve vidaları kutu içerisinde bulunmalıdır

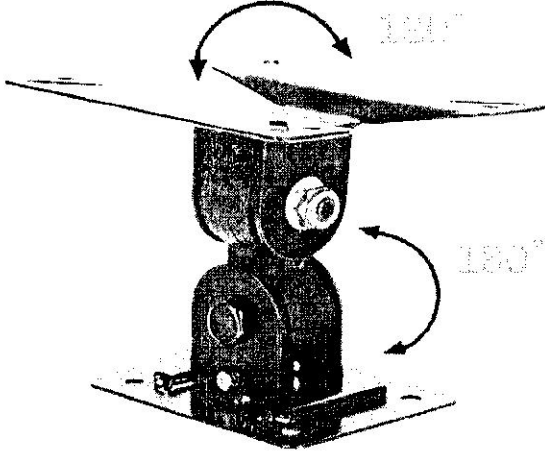

Duvara askı aparatıyla
monitör aparatı arasında
hareket ve montaj için
mesafe olmalıdır

VGA Kablo Teknik Özellikleri

Veri iletimindeki kayıplarınızı en aza indirmek ve yüksek iletim için 15-pin kablo içi 100% bakır malzemeden olmalı

Dış kaplaması, sert ve dayanıklı PVC kabuk sayesinde, kırılmaya, bükülmeye ve dış etkenlere karşı korunmalı

Ferit filtreli, dış kaynaklı elektromanyetik parazitlere karşı yüksek koruma sağlamalı

RFI VE EMI (kablesiz frekans parazitlerinin) temizlenmesini sağlamalıdır.

Kablo uzunlukları talepte belirtilmiştir,

Cat6 Konnektör Ucu

Cat-6 Kablolarla Uyumlu RJ45 konnektör

H. H. M. H. H. M.
B. H. M. H. H. M.
K. H. M. H. H. M.

H. H. M. H. H. M.
B. H. M. H. H. M.
K. H. M. H. H. M.

- 1- İstenilen ürün en az **2 Yıl Garantili** olup, orijinal kutusu ve ambalajında gelmelidir.
- 2- Ürüne teklif veren firmalar, ürün kod numarasını ve markasını belirtmek zorundadır.
- 3- Muayene Komisyonuna getirilen ürünler kontrolü için, ürünlerin kendi **WEB sitelerindeki** teknik özellikler ve kod numaraları ile birebir aynı olmalıdır.