



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

05/12/2019 09:19 - 52446582 - 949 - E.755



00107250783

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM MAUSE VE USB UZATMA KABLOSU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10.12/2019** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	MAUSE	50	ADET		
2	UZATMA KABLOSU USB 3.0	100	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

TEKNİK ŞARTNAME

USB Kablolı Mouse Özellikleri

4 Butonlu: (Sağ / Sol / x2 butonu ve Scroll)

2x butonu ile Windows ve ofis uygulamalarında çift tıklama fonksiyonlu

800 dpi çözünürlük

Tüm İşletim sistemlerinde Tek tekerlek ile uygulamaların kontrolü

Mouse Tak Çalıştır özelliğine sahip olmalıdır (yazılıma gerek duyulmadan)

USB 3.0 Uzatma Kablo Özellikleri

Kablo Uzunluğu 1 metre

Usb 3.0 Yüksek Hızlı veri transfer

Verimlilik: USB 3.0 4.8Gbps / USB 2.0 ile 480Mbps


Kablo Usb 2.0 İle Geriye Doğru Uyumlu olmalı

Bağlantı: A-Female / A-Male

M.Murat AKANLAR
Bilgisayar Tekhikeri
Bilgi İşlem Teknik Servis


Abdulkadir ÇINAR
Bilgisayar Tekhikeri
Bilgi İşlem Teknik Servis

Platoon Usb 3.0 Erkek Diři Uzatma Kablosu 1 Metre

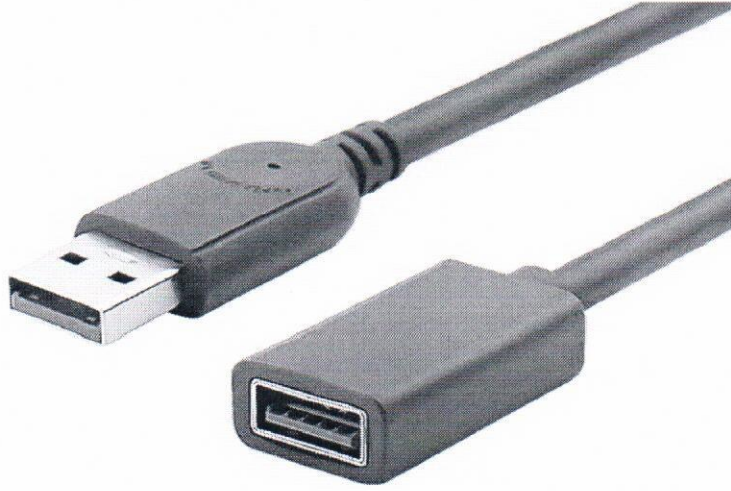

VEYA

Alfais 4626 Usb 3.0 Diři Erkek Uzatma Uzaticı 1 Metre

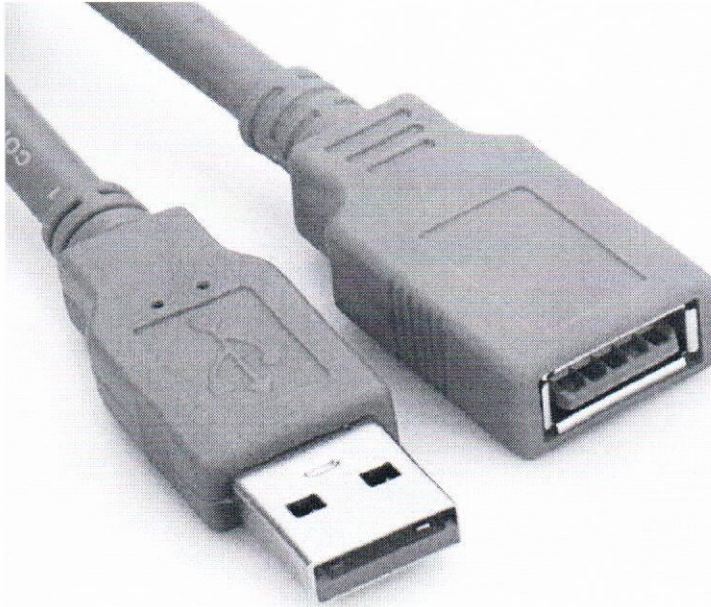

A4 Tech OP620-D USB Optik Kablolı Siyah Mouse

