



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
27/01/2020 16:08 - 52446582 - 949 - E 59



Sayı : 35277066-949

Konu : 7 KALEM VGA, HDMI KABLO VE DUVAR ASKI APARATI ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **30.01.2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

**e-imzalıdır.**  
**İrfan KÜÇÜKOĞLU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	5 METRE VGA KABLO	5	ADET		
2	10 METRE VGA KABLO	15	ADET		
3	15 METRE VGA KABLO	10	ADET		
4	20 METRE VGA KABLO	3	ADET		
5	HDMI KABLO 5 METRELİ	5	ADET		
6	HDMI KABLO 10 METRELİ	5	ADET		
7	DUVAR ASKI APARATI	5	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

*Marka Belirtiniz*

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 8f3bb2f8-cc7e-4dae-a6d4-b90cea100594 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

# TEKNİK ŞARTNAME

## VGA Kablo Teknik Özellikleri


Veri iletimindeki kayıplarını en aza indirmek ve yüksek iletim için 15-pin kablo içi %99,5 bakır malzemeden olmalı  
Dış kaplaması, sert ve dayanıklı PVC kabuk sayesinde, kırılmaya, bükülmeye ve dış etkenlere karşı korunmalı  
VGA Kablo başlıkları, takılacak bileşenin Portlar üzerine sabitlenmesi için, Standoff kilit vidalamalı olmalı  
Ferit filtreli, dış kaynaklı elektromanyetik parazitlere karşı yüksek koruma sağlamalı  
RFI VE EMI (kablesiz frekans parazitlerinin) temizlenmesi bulunmalıdır.

## HDMI Kablo Teknik Özellikleri

Veri iletim kayıplarını en aza indirmek için 96100 Bakır Altın Kaplama HDMI kablo içi %99,5 bakır malzemeden olmalı  
Kırılma, bükülme ve tüm dış etkenlere karşı koruma sağlayan, sert ve dayanıklı PVC kabuk kaplamalı  
2160P FULL HD görüntü kalitesi desteklemeli ve HDMI versiyon 1.4 3D uyumlu olmalı  
Ses sinyallerini: PCM, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, True HD ve DTS HD sorunsuz aktarabilmeli  
HDMI Ethernet Channel fonksiyonu yer alarak, HDMI ağ desteği ile cihazlar arasında hızlı veri transferi gerçekleştirmeli  
RFI (radyo frekans parazit) karşı korumalı olmalıdır.

## Monitör Duvar Askı Aparatında İstenilen Özellikler

LCD ve LED monitörlerine uygun olup, dış malzemesi gerçek döküm çelikten olmalı  
Monitör montaj: 15" ile 24"(widescreen) ve 17" ile 19"(kare) ekranlara uyumlu olmalı  
Montaj sonunda aparat hareketleri; Yukarı, aşağı, sol ve sağ yönler 90° dönebilmeli  
Dış malzemesi gerçek döküm çelikten olup, taşıyabileceği ağırlık 15Kg(max) olmalı  
Vesa standartlarına: 100x100, 75x75, 50x50 ölçülerine tam uyumlu olmalı  
Montaj için tüm aparatlar ve vidaları kutu içerisinde bulunmalıdır.

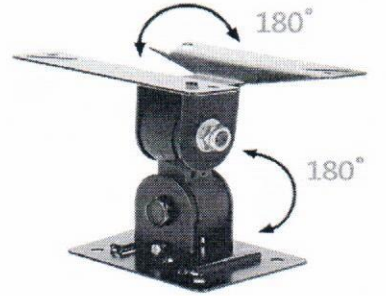

- 1- İstenilen **kablo uzunlukları talepte** belirtilmiştir.
- 2- Fiyatı Kabul edilen firma, ürün numunesi göndermelidir.
- 3- Teklif veren firmalar, ürün kod numarasını ve markasını belirtmelidir.
- 4- Ürünler **1 YIL Garantili** olup, açılmamış orjinal ambalajlarında gelmelidir.
- 5- Garanti süresi boyunca ambalajından çıkartılan ürün, hasarlı ve arızalı olması halinde firma tarafından **10(on) iş günü** içinde birebir değişimi yapmalıdır.

**Murat AKANLAR**

Bilgi İşlem Teknik Servis  
Bilgisayar Teknikeri

**Abdulkadir ÇINAR**

Bilgi İşlem Teknik Servis  
Bilgisayar Teknikeri